

مارس حياتك الطبيعية مع ديدويا®



أنت ديدوبيا

الآن وبعدما تعرفت على ما يجب فعله، سوف يواصل فريق ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك دعمك ومساعدتك على جعل دواء ديدوبيا جزءاً من حياتك اليومية.

سوف تحصل على هذا الكتيب من مقدم الرعاية الصحية حتى تتعرف على المعلومات بما يمكن أن تتوقعه في المستقبل، وكيفية استخدامه، والحفظ على أنابيب ومضخة ديدوبيا، والعناية بالثقب وكيفية التعود على تعاطي هذا الدواء وطريقة إنجاز المهام اليومية مع تعاطيه.

جدول المحتويات

٢	الخطوات المقبلة.....
٥	ديدوبيا.....
٩	العلبة التعود على الدواء.....
١٤	الأنشطة اليومية.....
١٦	معلومات مفيدة.....
١٦	تخزين ديدوبيا.....
١٧	العناية بالمضخة.....
١٨	أزرار المضخة.....
١٩	تحذيرات المضخة.....
٢١	استبدال بطاريات المضخة.....
٢٢	الأسئلة الشائعة.....
٢٤	معلومات مهمة عن ديدوبيا.....
٢٥	الأسئلة.....

من المهم أن يتتوفر لديك أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدتك على التعامل مع هذا الدواء.

لذا برجاء قراءة ومعرفة المزيد عن ديدوبيا!

الخطوات المقبلة

الآن وبعد أن وضعت أنبوب التغذية إلى المعدة والأمعاء عن طريق الجلد، بمساعدة فريق الرعاية الصحية، يجب أن تتعود على هذا الدواء الجديد.

وبعد أن بلغنا هذه المرحلة وقد تعرفت على ديدوبيا، سوف يتولى طبيبك المعالج تعديل الجرعة وسوف تتم برمجة المضخة لتحصل على علاجك اليومي.

من الضروري خلال الخطوة المقبلة في رحلة العلاج أن تشعر بالثقة في هذا الدواء وبالدعم من جميع المحيطين بك.

ماذا المقصود به؟

أنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء عن طريق الجلد – هو الأنابيب الذي يحمل الدواء من العلبة مباشرةً إلى أمعاءك.

دعم المريض

في الوقت الذي تبدأ فيه العلاج بديدوبيا، قد يتفاوت مستوى الدعم الذي تحتاجه من مقدم وفريق الرعاية الصحية. ومع ذلك، يجب أن تعلم أن الدعم دائمًا موجود كلما احتجت إليه.

- سوف يدعمك أفراد أسرتك ومقدمي الرعاية الصحية في كل خطوة على طريق العلاج، وسوف تقدر لهم بدرجةٍ كبيرة هذا الدعم والمساعدة.
- ناقش مع المقربين إليك كم تريد أن تكون قادراً على تولي مهمة إدارة علاجك اليومي بنفسك.
- لا تخجل من طلب المساعدة
- كن ايجابياً - فمع تعودك على العلاج الجديد، سوف تتحول الأمور التي بدت صعبة في البداية لتصبح أكثر سهولة.

ديودوبيا

الغاية مع تناول ديوودوبا

سوف يتحدث فريق الرعاية الصحية الخاصة بك عن المشكلات الممكن أن تواجهك عند استعمال الدواء الجديد.

من خلال اتخاذ بعض الخطوات الوقائية، يمكنك أن تساعد في الحد من ظهور بعضٍ من هذه المشكلات:

- اغسل يديك قبل توصيل أو فصل المضخة.
- افحص التقب للتحقق من عدم وجود إحمرار أو ألم أو تصريف؛ فقد تكون هذه علامات للتلوث
- اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية حول كيفية تنظيف والغاية بالثقب في الجلد
- حرك الأنبوب حسب تعليمات مقدم الرعاية الصحية
- اغسل الأنبوب لمنع انسداده
- افحص الأنابيب يومياً للتأكد من ثنيها أو التوائها وانتبه ألا تحرك أو تلوى أنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء
- تحقق من عدم تلف المضخة

الغاية بالثقب

اتبع تعليمات فريق الرعاية الصحية الخاصة بطريقة تنظيف الثقب

الثقب هي الفتحة في معدتك التي جهزت ابان العملية. بعد ان يتعاافى الجرح (بعد اسبوع او اسboween) يجب تحريك الانبوب داخل وخارج الثقب كل يوم بحسب التعليمات التالية او حسب تعليمات الطبيب

١. فك لوح التثبيت للسماح بحرية الحركة لأنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء


٢. ادفع بعناية الأنبوب ٣ إلى ٤ سم إلى داخل المعدة ثم اسحب للخلف برفق حتى تشعر بوجود مقاومة من لوح التثبيت الداخلي؛ لا تلوي الأنبوب (الشكل رقم ١)

٣. افحص الثقب للتأكد من عدم وجود أي إحمرار أو تورم أو ألم، وأبلغ طبيبك المعالج بأي علامات تشير لوجود مضاعفات؛ لا تضع أي مرهم على الثقب


٤. أعد وضع لوح التثبيت الخارجي إلى مكانه الأصلي (حوالى ١ سم بعيداً عن الجلد؛ الشكل رقم ٢)

من المهم تثبيت لوح التثبيت الخارجي بشكل مععدل دون إفراط أو تفريط. إذا كنت تشعر بعدم تثبيته كما يجب، اتصل بفريق الرعاية الصحية لطلب المشورة.

صورة رقم ١

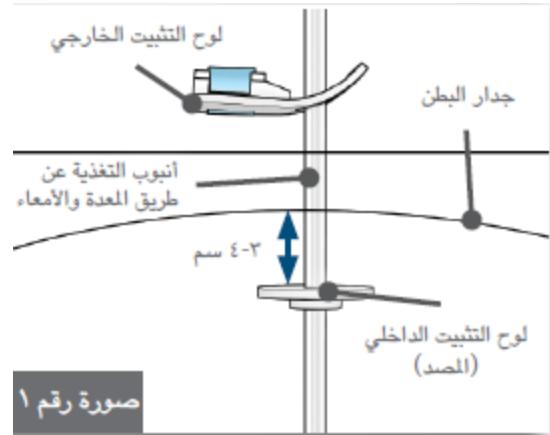

صورة رقم ٢

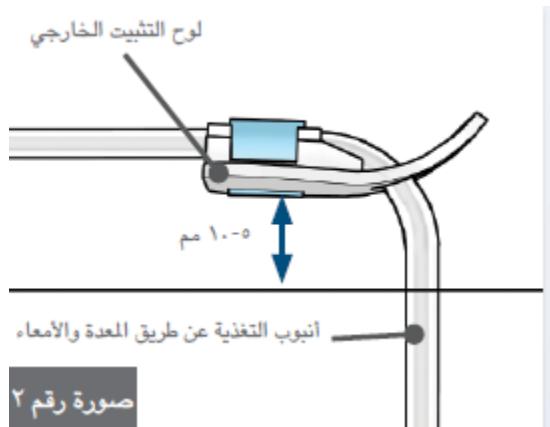

يُرجى التأكد من أن صور الأنابيب متوافقة مع الأنابيب المستخدمة في بلدك.

يُرجى التأكد من أن التعليمات الواردة أعلاه تتبع معلومات NJ الخاصة بالأنابيب للمستخدمين ومعلومات تنظير الجهاز الهضمي للمستخدمين، ومتوافقة مع بلدك.

الغاية بالأنابيب - كل مساء

الخطوة الأولى - إيقاف المضخة

- انقر بشكل دائم على زر إيقاف/تشغيل (STOP/START) لمدة ٣ ثوان لوقف الضخ
- انقر بشكل دائم على زر فتح/قفل (ON/OFF) لمدة ٣ ثوان لإطفاء المضخة.

إيقاف المضخة
الخطوة الأولى



- انقر بشكل دائم على زر إيقاف/تشغيل (STOP/START) لمدة ٣ ثوان لوقف الضخ
- انقر بشكل دائم على زر فتح/قفل (ON/OFF) لمدة ٣ ثوان لإطفاء المضخة.

الخطوة الثانية – فصل الأنابيب

- افصل أنبوب العلبة من الفتحة المغوية لأنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء (قم بلي أنبوب العلبة، وليس أنبوب التغذية)

فصل الأنابيب

الخطوة
الثانية



- افصل أنبوب العلبة من الفتحة المغوية لأنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء (قم بلي أنبوب العلبة، وليس أنبوب التغذية)

الخطوة الثالثة – الغسل

- استخدم حقنة لغسل الأنابيب المغوية بمياه الشرب بدرجة حرارة الغرفة وفقاً لتعليمات الطبيب المعالج؛ يُرجى الاتصال بالطبيب المعالج إذا كانت لديك أي أسئلة.
- عند وضع الأنابيب الداخلية والخارجية لأكثر من عام، يجب أن يُقيِّم الطبيب المعالج وظائفها بانتظام
- لا تتعاطى أي مواد أخرى غير ديودوبا في أنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء دون استشارة الطبيب المعالج.
- لا يجب غسل أنبوب التمديد؛ قم بخلعه وتقطيعه ووضعه في الثلاجة كل ليلة
- يجب تنظيف أنابيب التغذية الخارجية والموصلات بانتظام بالماء الدافئ مع الصابون

الخطوة الثالثة

الغسل



استخدم حقنة لغسل الأنابيب المعوي بمياه الشرب بدرجة حرارة الغرفة وفقاً لتعليمات الطبيب المعالج؛ يُرجى الاتصال بالطبيب المعالج إذا كانت لديك أي استثناء.

عند بقاء الأنابيب الداخلية والخارجية لأكثر من عام، يجب أن يُقيّم الطبيب المعالج وظائفها بانتظام.

لا تتعاطى أي مواد أخرى غير ديوودوبا في أنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء دون استشارة الطبيب المعالج.

لا يجب غسل أنبوب التمديد؛ قم بخلعه وتغطيته ووضعه في الثلاجة كل ليلة.

يجب تنظيف أنابيب التغذية الخارجية والموصلات بانتظام بالماء الدافئ مع الصابون.

يُرجى التأكد من أن صورة الأنابيب متوافقة مع الأنابيب المستخدمة في بلدك.

الغاية بالأنبيب

اغسل الفراغ بين الأنبوب المعوي وأنبوب التغذية بمياه الشرب يومياً.

استعمل حقنة لغسل الوصلة التي على شكل واي بماء الشرب بدرجة حرارة الغرفة حسب تعليمات الطبيب.

اغسل الوصلة على شكل حرف واي



اغسل الوصلة على شكل حرف واي

للتأكد من أن الأنابيب تعمل بشكلٍ طبيعي، يجب أن يُقيم الطبيب المعالج الأنابيب الداخلية والخارجية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

إذا كان من الصعب عليك تنظيف الأنبوب، لا تدفع الماء داخل الأنبوب واتصل بមقدم الرعاية الصحية.

يرجى التأكد من أن صور الأنابيب متوافقة مع الأنابيب المستخدمة في بلدك.

التعود على الدواء

سوف يصبح ديدوبا جزءاً من حياتك اليومية، فاجعله شيئاً روتينياً وسوف يساعدك على التعود على استعماله والتركيز في حياتك اليومية.

كل صباح

فيما يلي تعليمات حول تعاطي جرعة الصباح اليومية من ديدوبا، أو الاطلاع على دليل المضخة لمزيدٍ من التفاصيل حول استخدامها. قبل الاستخدام، يجب تخزين علب ديدوبا في الثلاجة في درجة حرارة (٢ - ٨ درجة مئوية). لمزيدٍ من المعلومات عن كيفية التخزين، انظر صفحة ١٦.

١. أخرج علبة ديدوبا من الثلاجة؛ ولا تُعد استخدام علبة مفتوحة.

٢. اترك العلبة حتى تكتسب درجة حرارة الغرفة.

٣. اغسل يديك

٤. وصل علبة ديدوبا الجديدة بالمضخة. لعمل هذا، يجب عليك أو مقدمة الرعاية الصحية:

أ. ادخال خطاف العلبة بمسامير مفصلة المضخة.

ب. وضع المضخة في وضع مستقيم على سطح مستوٍ.

ج. الضغط بحيث تثبت العلبة جيداً في المضخة

د. ادخال عملة معدنية في المزلاج وادارته عكس اتجاه عقارب الساعة حتى الشعور بأن المزلاج قد دخل في مكانه (سوف يكون الخط الموجود على المزلاج موازيًّا للخط السهم الموجود على المضخة).

هـ. التأكد من تثبيت العلبة جيداً



٥. ضع المضخة في الكيس المخصص لحملها قبل وضعها (انظر صفحة ١٤ لمعلومات حمل المضخة)
٦. قم بإزالة غطاء الحماية الأحمر من أنبوب العلبة
٧. صل أنبوب العلبة بالفتحة المعوية بأنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء (قم بلي أنبوب العلبة وليس أنبوب التغذية)



٨. اضغط بشكل دائم على زر فتح/قفل (on/off) لمدة ٣ ثوان لتشغيل المضخة. اضغط بشكل دائم على زر إيقاف/تشغيل لمدة ٣ ثوان لبدء الضخ

٩. اضغط على الجرعة الصباحية (Morning Dose) مرتين لتعاطي الجرعة

طوال اليوم

فور حصولك على جرعتك الصباحية، يتم أخذ جرعة صيانة أقل يُطلق عليها **جرعة الصيانة المستمرة طوال اليوم** عن طريق المضخة حتى النوم.

يُحصل على جرعة الصيانة المستمرة هذه تلقائياً عن طريق المضخة بعد أخذ الجرعة الصباحية.
لست مضطراً للضغط على الأزرار الإضافية للمضخة.

الجرعات الإضافية

تسمح خاصية الجرعة الإضافية طوال اليوم بالحصول على جرعة إضافية إذا لزم الأمر ووفقاً لتعليمات طبيبك المعالج.

للحصول على جرعة إضافية، اضغط على زر **جرعة إضافية "Extra Dose"** في المضخة، وسوف تضخ المضخة **الجرعة الإضافية** بعد الجرعة المستمرة.

كل مساء

يُستخدم ديدودوبا طوال اليوم، ويتوقف المريض عن تعاطي الدواء في المساء عندما يخلد إلى النوم.
اتبع هذه التعليمات:

١. اغسل يديك
٢. اضغط بشكل دائم على زر **إيقاف/تشغيل** لمدة ٣ ثوان لوقف المضخة
٣. اضغط بشكل دائم على زر **فتح/غلق** لمدة ٣ ثوان لقلل المضخة

٤. افصل أنبوب العلبة من الفتحة المغوية بأنبوب التغذية عن طريق المعدة والأمعاء (قم بلي أنبوب العلبة وليس أنبوب التغذية)

٥. فور وقف المضخة وفصلها من الفتحة المغوية لأنبوب التغذية، تذكر العناية بالأنبوب على النحو المبين في الصفحتين ٧ و ٨

٦. ضع الغطاء الأبيض مرةً أخرى على أنبوب التغذية والغطاء الأحمر على أنبوب العلبة

٧. تخلص من علبة ديدوبا

٨. استخدم حقنة لغسل الانابيب على النحو المبين في الصفحتين ٧ و ٨

٩. نظف التقب وفقاً لتعليمات فريق الرعاية الصحية.



بقايا الجل الموجودة في علبة ديدوبا

من الطبيعي أن تترافق بعض بقايا الجل في العلبة بعد الضخ لمدة ١٦ ساعة. يجب التخلص من هذه البقايا وفقاً لتعليمات فريق الرعاية الصحية.

من الضروري عدم استخدام هذه البقايا من الجل مرةً أخرى.

نصائح مهمة

- احصل على أكسسوارات مريحة لحمل المضخة وتساعد على جعل المضخة قريبة من الجسم حتى تظل الانابيب بحالة سليمة (أنظر صفحة ١٤)
- انتبه طوال اليوم لأنها لا تخرج الانابيب
- المضخة غير مضادة للماء، لذا يُرجى الانتباه إلى الحفاظ على جفاف المضخة طوال الوقت
- إذا كنت تخطط للخروج للتسوق، فيفضل الخروج في غير أوقات الذروة شديدة الازدحام
- يجب وضع المال وبطاقات الائتمان في مكان بعيد عن الأنابيب
- تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حتى يتدخل إذا احتجت إلى مساعدته
- اطلب المساعدة عند الحاجة إليها

سوف يساعد القيام بدور نشط في التخطيط لأنشطتك على الاستفادة بأكبر قدر من اليوم. كما ان التعود على نظام الحياة الجديد سوف يستغرق بعض الوقت منك ومقدم الرعاية الصحية، وهذا طبيعي. تحل بالصبر واستمر في إيجابيتك.

الأنشطة اليومية

هناك عدد من الأكسسوارات المصممة خصيصاً للمساعدة على حمل مضخة ديدوبا، حيث صُممـت للتأكد من تثبيـت المضـخـة بالـقـرـبـ منـ الجـسـمـ حتـىـ لاـ تـخـرـجـ الأنـابـيبـ بـسـهـولةـ وـتـظـلـ فـيـ مـكـانـهـاـ.

قد يقدم فريق الرعاية الصحية بعض اقتراحات أخرى لتسهيل حمل المضخة والأنابيب



▪ حقية الورك: يتم ارتداء هذه الحقية فوق الورك الأيسر أو الأيمن أو في الجزء الخلفي من الخصر



▪ السترة/الصدرية: جيوب تساعد على تقارب المصحة من الجسم



▪ حقية اليد: يساعد حزام الخصر على تخفيف الضغط من على الكتف



▪ جراب المضخة: مُصمم لأخفاء المضخة تحت الملابس العادية

الاستحمام أو السباحة

فور التئام التقب، يمكنك الاستحمام أو ممارسة السباحة.

مضخة ديدوبا غير مضادة للماء، لذا يجب فصلها قبل الاستحمام أو السباحة.

يجب تجفيف المنطقة المحيطة باللقب برفق قبل إعادة توصيل مضخة ديدوبا.

لن تحصل على أي علاج خلال فترة فصل المضخة، وهذا قد يعني أنه قد تتفاقم حدة الأعراض فجأة أو ببطء. إذا حدث هذا، يرجى الرجوع إلى الطبيب المعالج لمعرفة ما يجب فعله.

معلومات مفيدة: تخزين ديدوبا

يعرض هذه القسم المزيد من المعلومات عن ديدوبا والعناية بالمضخة. يتميز ديدوبا بأنه حساس للضوء والحرارة، لذا يجب تخزينه بشكلٍ صحيح.

- يجب الإبقاء على الكرتون الذي يحتوي على علب ديدوبا مغلقة لحمايتها من الضوء باستثناء الوقت الذي يتم فيه إخراج علبة جديدة
- يجب تخزين كرتون ديدوبا في الثلاجة عند درجة حرارة (٢ إلى ٨ درجة مئوية)
- عند الحصول على كرتون جديد لديدوبا، ضعها خلف الكراتين الأقدم في الثلاجة. هذا يضمن استعمال الكرتون الأقدم أولاً.
- يجب استخدام العلبة قبل انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على الكرتون.
- قد يصفر لون الجل الموجود داخل علبة ديدوبا قليلاً. هذا أمر عادي ولا يؤثر على استعمال الدواء



معلومات مفيدة: العناية بالمضخة

استشر الطبيب المعالج في الحال إذا كنت تعتقد أنه هناك مشكلة في المضخة. سوف تساعد الإجراءات التالية على الحفاظ على حالة المضخة وصلاحيتها للعمل.

تنظيف المضخة

- يجب تنظيف المضخة بانتظام بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر.
١. بلل قطعة القماش بالماء والصابون وامسح السطح الخارجي للمضخة.
 ٢. جفف سطح المضخة بقطعة قماش أخرى ناعمة وخالية من الوبر.
 ٣. تأكد من أن المضخة جافة تماماً ودائماً قبل استخدامها مرةً أخرى.
 ٤. يجب عدم غمس المضخة على الإطلاق في الماء أو أي نوع من سوائل التنظيف.



لا تشغّل المضخة عند درجة حرارة أقل من ٢ درجة مئوية أو فوق ٤٠ درجة مئوية
لا تخزن المضخة عند درجة حرارة أقل من ٢٠ درجة مئوية أو فوق ٦٠ درجة مئوية

معلومات مفيدة: أزرار المضخة

تعرف على الأزرار

فيما يلي عرض سريع للأزرار التي سوف تستخدمها للتحكم في الجرعة.
يرجع إلى التعليمات الفردية في الصفحات ١٠ إلى ١٢ على التوالي وعدد مرات الضغط على كل زر



معلومات مفيدة: إنذارات المضخة

الرسالة	الصوت الصادر	السبب	الإجراء المتبوع
البطارية فارغة	إنذار من نغمتين	البطارية ضعيفة، سوف توقف المضخة	ضع بطاريات جديدة لإعادة تشغيل المضخة
البطارية غير موجودة، سوف توقف المضخة عن العمل	إنذار من نغمتين	تمت إزالة المضخة أثناء عمل المضخة أو أن البطارية ضعيفة للغاية	اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. أعد تركيب البطاريات أو ركب بطاريات جديدة.
خطأ	إنذار من نغمتين	المضخة تحتاج إلى الإصلاح	أغلق مشبك الأنابيب وتوقف عن استخدام المضخة، واتصل بالطبيب المعالج.
الضغط مرتفع	إنذار من نغمتين	الضغط مرتفع داخل النظام نظراً للبقاء الأنابيب أو غلق مشبك الأنابيب	اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لإيقاف المضخة وإلزار لمدة دقيقتين. تخلص من الانسداد وأعد تشغيل المضخة. إذا استمر صوت الإنذار، اتصل بالطبيب المعالج.
أحد المفاتيح معلق، رجاء إعادةه لوضعه الطبيعي	إنذار من نغمتين	هناك ضغط بشكل متواصل على أحد المفاتيح (الازرار) معلق	توقف عن الضغط على المفتاح (الزر). إذا استمر الإنذار، أغلق مشبك الأنابيب وتوقف عن استخدام المضخة. اتصل بالطبيب المعالج.

البطارية ضعيفة نغمتين كل دقيقتين	البطارية ضعيفة ولكن المضخة مازال ت العمل	غير البطاريات في أقرب وقت
المحرك مغلق، افصل الكهرباء	إنذار من نغمتين	ركب بطاريات جديدة وأعد توصيل محول التيار المتردد وأعد تشغيل المضخة
لا علبة، وجود أنابيب التنبيب	إنذار من نغمتين	اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. ثبت أو افصل الأنابيب من فتحة التغذية عن طريق المعدة والأمعاء. أعد توصيل العلبة
لا علبة، المضخة لا تعمل	إنذار من نغمتين	اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. أدخل العلبة وإعد تشغيل المضخة
(لا توجد رسالة)	إنذار من نغمتين	تم إزالة البطاريات أثناء عمل المضخة ولا يوجد محول تيار متعدد. تم إيقاف المضخة.

اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. أوقف المضخة وغير البطاريات أو تخلص من مصدر الكهرباء	المضخة كانت تعمل أثناء انقطاع الكهرباء	إنذار من نغمتين	انقطعت الكهرباء أثناء عمل المضخة
أعد توصيل السلك أو اضغط على زر التالي "NEXT" لوقف الإنذار	تمت إزالة سلك الجرعة عن بعد	صفارتان من نغمة واحدة، إذا توقفت المضخة عن العمل. إنذار من نغمتين إذا تم تشغيل المضخة	تمت إزالة سلك الجرعة عن بعد
اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. ضع علبة جديدة وأعد ضبط حجم المخزون	لا يوجد دواء في العلبة	إنذار من نغمتين	العلبة فارغة من الدواء
غير العلبة قبل أن تصبح فارغة	حجم المخزون في العلبة ٥ مل	٣ صفارات مفردة	حجم المخزون منخفض
اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. تأكد من وضع العلبة بمحاذاة المضخة واترك الدواء ليكتسب درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بالمضخة	علبة ديودوبا لسيت بمحاذاة المضخة، وأن الدواء لا يتدفق من حقيبة العدواء إلى المضخة، الدواء بارد جداً	صفارتان (طويلة قصيرة)	(الشاشة تعرض وضع المضخة الحالي)
اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. المضخة ما زالت تعمل ولكن اتصل	المضخة مجدولة للخدمة	إنذار من نغمتين	رسوم الخدمة ارجع إلى الدليل

بالطبيب المعالج لمزيد من التعليمات			
اضغط على زر إيقاف/تشغيل "STOP/START" أو التالي "NEXT" لوقف الإنذار. تخلص من الانسداد أو أعد توصيل العلبة بالمضخة. أعد تشغيل المضخة إذا استمر صوت الإنذار، اتصل بالطبيب المعالج	تم ضبط جهاز استشعار انسداد المصدر على الوضع "جاف"، وتم اكتشاف وجود انسداد	إنذار من نغمتين	انسداد في مصدر الضخ

معلومات مفيدة: استبدال بطاريات المضخة

طريقة استبدال بطاريات المضخة

يجب استخدام بطاريات قلوية عادية غير قابلة لإعادة الشحن من نوع "LR6/AA". يجب استبدال بطاريات المضخة بانتظام. سوف يصدر صوت إنذار إذا كانت البطارية منخفضة.

١. أوقف المضخة

٢. افتح مقصورة البطاريات عن طريق الضغط على زر السهم مع فتح الغطاء.


٣. تخلص من البطاريات المستعملة من سحب طرف شريط البطارية

٤. ضع البطاريات الجديدة عند الجزء العلوي من شريط البطارية مع التأكد من وضع الطرفين "الإيجابي + والسلبي -" للبطارية بمحاذة الرموز داخل مقصورة البطاريات.

٥. سوف تعمل المضخة تلقائياً

٦. أعد تركيب غطاء البطاريات

٧. شغل المضخة إذا لزم الأمر

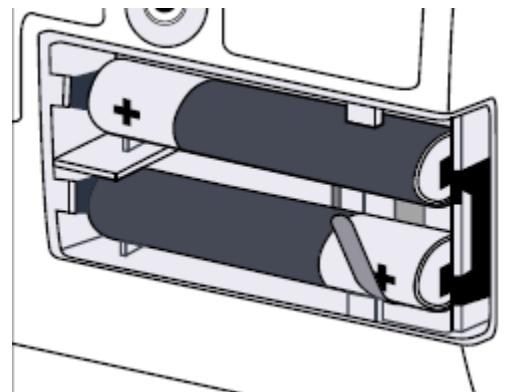

تحذير!

لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن نظراً لأنها لا توفر الكمية الكافية من الكهرباء حتى تعمل المضخة

بشكلٍ صحيح.

الأسئلة المتكررة

هل هناك أي معلومات مهمة للغاية بحسب أن أعرفها عن ديدوبيا؟

يمكن أن يتسبب ديدوبيا في ظهور أعراض جانبية. ومع ذلك، فإنه يمكن السيطرة على العديد منها من خلال تعديل الجرعة. اتصل بالطبيب المعالج لمناقشة أي أسئلة حول الآثار الجانبية. إذا شعرت بأي آثار جانبية، اتصل بالطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن.

كم مدة تعاطي ديدوبيا؟

قد تتعاطى ديدوبيا لمدة تصل إلى ١٦ ساعة كحد أقصى، ولكن اتبع دائمًا تعليمات الطبيب.

ما يحدث إذا شعرت بتفاقم الأعراض فجأة أو ببطء؟

من الممكن أن يكون الأنابيب المعاوي قد تعرض للانسداد أو تم فصله أو قد يكون قد تحرك. اتصل بالطبيب المعالج مباشرةً إذا حدث هذا. قد ينظر الطبيب أيضًا في تعديل الجرعة. اتبع دائمًا تعليمات الطبيب المعالج بكل دقة عند استعمال ديدوبيا.

ما عدد العلب التي سوف أستخدمها؟

يتوقف هذا على الجرعة التي تحتاجها والتي يحددها الطبيب. قد يحتاج المرضى أكثر من علبة في اليوم الواحد.

لماذا تراكم بقايا للجل داخل العلبة؟

قد تجد بقايا للجل داخل العلبة بنهاية اليوم. هذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق. يجب ألا تتم إعادة استخدام العلبة التي يوجد بها بقايا للجل. تخلص دائمًا من جميع العلب العلبة التي تستخدمها بنهاية اليوم وفقًا لتعليمات فريق الرعاية الصحية.

هل يمكن لأي أدوية أن تتفاعل مع ديدوبيا

أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلاني بأي أدوية أخرى تناولتها مؤخرًا أو قد تتناولها. يشمل هذا الأدوية التي تتناولها دون وصفة طبية (روشيتة) بما في ذلك الأعشاب الطبية.

تحدث إلى الطبيب المعالج أو الصيدلاني قبل البدء في تعاطي ديدوبيا إذا كنت تتعاطى أدوية أخرى لـ:

- مرض الشلل الرعاش "باركنسون" وردود الفعل التحسسية الحادة والربو والتهاب الشعب الهوائية وأمراض القلب وانخفاض ضغط الدم
- النوبات أو الصرع
- ارتفاع ضغط الدم
- المشاكل العقلية
- الاكتئاب
- السل
- القلق
- فقر الدم "الأنيميا"
- الغثيان
- التشنجات في الأوعية الدموية

هل يتفاعل الطعام مع ديدوبا؟



يمكن تعاطي ديدوبا مع أو بدون الطعام. قد لا يتم امتصاص ديدوبا جيداً في بعض المرضى إذا تم تعاطيه مع، أو بعد مدة قصيرة من تناول الطعام الغني بالبروتين (مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب والمكسرات). يجب استشارة الطبيب المعالج إذا انطبق هذا عليك.

معلومات مفيدة عن ديدوبا

تشمل الآثار الجانبية الشائعة من ليفودوبا (المادة الفعالة في ديدوبا) على سبيل المثال لا الحصر:

- حركات لا يمكن السيطرة عليها (خلل في الحركة)؛ تفاقم حدة مرض باركينسون
- الشعور بالإعياء؛ الإمساك
- نقص الوزن
- القلق؛ الاكتئاب؛ الأرق
- الشعور بالدوخة، خاصةً عند الوقوف بسبب انخفاض ضغط الدم
- الإغماء

تشمل الآثار الجانبية الشائعة من الأنابيب المعلوي (على سبيل المثال لا الحصر):

- تلوث الجرح من الجراحة

- ألم في المعدة
- ندب عميقه بعد الجراحة
- المضاعفات الناتجة عن إدخال الجهاز مثل ألم في الفم والحلق؛ انتفاخ المعدة؛ عدم ارتياح في المعدة؛ ألم؛ تهيج الحلق؛ إصابة الجهاز الهضمي؛ نزيف داخلي؛ قلق؛ صعوبة في البلع؛ قيء؛ ريح أو غازات البطن
- إحمرار موضع الشق؛ تفريغ ما بعد إجرائي؛ ألم إجرائي؛ رد فعل إجرائي
- إذا تناولت جرعة مفرطة من ديدوبا، اتصل دائمًا بالطبيب المعالج أو ممارس الرعاية الصحية المدرب أو اذهب إلى أقرب مستشفى.
- لا تشمل المعلومات الواردة أعلاه كل شيء عن ديدوبا. يُرجى الرجوع إلى نشرة المستخدم التي تأتي مع ديدوبا لمعرفة المعلومات الكاملة عن المنتج.

ما المقصود به؟

ليفودوبا – المادة الفعالة في العديد من الأدوية المستخدمة في علاج مرض الشلل الرعاش "باركنسون". تُستخدم في جميع المراحل ويمكن أن تعالج العديد من أعراض هذا المرض.

الأسئلة؟

إذا كانت لديك أي أسئلة عن دواء ديدوبا، أو عن المواضيع التي لم ترد في الكتيب، يُرجى الاتصال بفريق الرعاية الصحية.

قد يساعد طرح الأسئلة على معرفة كل ما يخص دواء ديدوبا

اعتبارات العلاج المهمة

للإبلاغ عن أي أعراض جانبية خاصة بمستحضر الدييودوبا يرجى الإتصال على الخط الخاص بشركة أبفي بايوفارماسيوتيكالس جي إم بي إتش.

الرياض: ٠٠٩٦٦١١٢١٨٠٠١١

جدة: ٠٠٩٦٦١٢٦٥٧٣٠٤٤

للإتصال بالإدارة التنفيذية للتيقظ وإدارة الأزمات - هيئة الغذاء والدواء السعودية:

فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

هاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٠٣٨٢٢٢

تحويلة: ٢٣٤٠-٢٣٥٣-٢٣٥٦-٢٣١٧-٢٣٣٤-٢٣٥٤

الهاتف المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa/npc